THERMOMETRE BIG FLEX COMED
REF 68 000 83

Nous vous remercions d'avoir choisi ce modèle de thermomètre.
Ce thermomètre convient pour la mesure des températures corporelles de l'enfant et de l'adulte.
Veuillez prendre connaissance de la notice d'utilisation et la conserver.

A) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MODELE

Etendue de mesure : 32,0 à 42,9 ℃
Précision : +/-0,1 ℃ entre 35 et 39 ℃ +/-0,2 ℃ au-delà
Affichage : Ecran digital LCD 31/2 (graduation : 0.01℃/℉)
Alimentation : Pile bouton LR1130 alkaline
Consommation d'énergie : 0.15mW
Dimensions : 137 x 34 x 15 mm
Durée de vie de la pile : + 250 heures en utilisation soit plus de 1.000 prises
Poids : 22 grammes

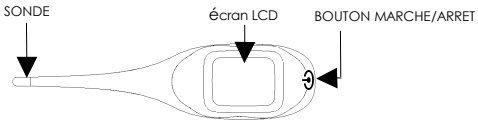

B) PRISE DE LA TEMPERATURE

- Appuyer légèrement sur la touche, un bip signale l'allumage
- Fonction mémoire : après mise en marche, la dernière mesure est affichée avec la lettre « M »
- Ré-appuyer sur la touche, apparaît sur l'écran « Lo℃ » le thermomètre est alors prêt. Le symbole « ℃ » va clignoter pendant minimum 16 secondes, le temps de la prise de mesure.
- Puis ne sonnerie retentit pendant 10 secondes signalant la fin de la prise de température :

Si la température est normale (soit en-dessous de 37 ℃) une alarme « bi...bi...bi...bi» va retentir.
Si le sujet a de la fièvre il a une une alarme spéciale « bi,bi, bi ».

- Durant la mesure l'écran affiche « Lo℃ » ou « Lo℉ » si la température mesurée est en dessous de 32℃ (90℉) et « Hi ℃ » ou « Hi℉ » si la température mesurée est au dessus de 43℃ (109.9℉)
- Pour éteindre le thermomètre, appuyer sur le bouton , le thermomètre s'éteint automatiquement au bout de 9 minutes.

Attention : ne pas laisser un enfant utilisé ce thermomètre sans la présence d'un adulte.

C) METHODES DE PRISE DE TEMPERATURE

a) Température rectale :
Lubrifier la sonde avec de la vaseline pour faciliter l'insertion.
Introduire doucement l'embout d'environ 2 cm dans le rectum. Mesure effectuée en moins d'une minute.
Température moyenne normale 37 ℃.

b) Température buccale :
Placer la tête de la sonde sous la langue contre le frein de la langue. Bien refermer la bouche et respirer très doucement par le nez. Mesure effectuée moins d'une minute.
Température moyenne normale 37,6 ℃.

c) Température axillaire :
Essuyer l'aisselle avec une serviette sèche. Caler la sonde au creux de l'aisselle et plaquer la bras contre le thorax. Mesure effectuée en moins d'une minute.
Température moyenne normale 36,7 ℃.

D) REMPLACEMENT DE LA PILE

Quand l'écran affiche « » la pile doit être changée.
Enlever le capot en le tournant à l'aide d'une pièce de monnaie
Mettre une pile bouton neuve
Vérifier la présence du joint d'étanchéité dans sa gorge et remettre le couvercle en le tournant sur le thermomètre.
Ne jamais jeter la pile ou le thermomètre dans le milieu naturel. Déposer la pile usagée dans un collecteur spécifique.

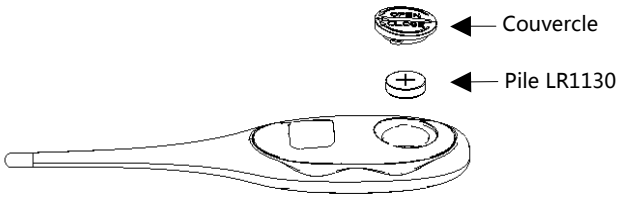

E) NETTOYAGE ET DESINFECTION

Le thermomètre est étanche. Avant et après utilisation, le nettoyer avec un tissu doux imprégné d'eau ou d'une solution de stérilisation. La solution de stérilisation recommandée est de l'alcool à 95%

A NOTER : L'utilisation d'une autre solution, d'un autre pourcentage d'alcool ou d'une autre méthode de nettoyage peut endommager le thermomètre (eau très chaude ou solutions nettoyantes agressives).
Pour les établissements de soins, se conformer au protocole de nettoyage/désinfection des instruments de mesure. Le thermomètre doit toujours être en bon état (absence de fissures) lorsqu'il est dans un liquide désinfectant.
Cet appareil ne nécessite pas de recalibrage et a une durée de vie d'environ 3 ans.

F) PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter toute exposition au soleil, à une source d'U.V. ou de chaleur intense.
Veiller à ne pas faire tomber, fêler ou cogner le thermomètre. Ne pas le tordre ou le démonter (retirer uniquement la pile).
Ne jamais le mettre dans de l'eau bouillante pour le stériliser
Ne jamais utiliser de solution chimique pour le nettoyer, éviter toute exposition au soleil ou près d'une source de chaleur car une importante source électromagnétique peut provoquer des interférences.
Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre +10 et +35℃ (+50℉ et +95℉) et à un taux d'humidité compris entre 40 et 80%.
Il doit être conservé et transporté à une température entre -10 et 40℃ (+14℉ et +104℉) et un taux d'humidité entre 30 et 90%.
Attention : ne jamais laisser ce produit ou la pile à la portée des enfants.

G) CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas de lésions importantes affectant les sites de prises, ou sur un sujet agité dans l'oreille

REMARQUES :

1) Cet appareil est destiné à la prise de température de l'adulte ou de l'enfant pour un usage médical.

2) La garantie est d'1 an à partir de la date d'achat dans le cadre d'un usage familial. Cependant cette garantie exclue les dégâts causés par le non-respect de ces consignes, une mauvaise utilisation, un choc ou un mauvais remplacement de la pile. Cette garantie ne s'applique pas à la pile et à l'étui.

3) Cet appareil est élaboré et produit selon les exigences de la norme EN12470--3 : performance des thermomètres électroniques compacts.

4) Cet appareil a passé des tests d'émission EMC, et le test d'immunité selon la norme EN60601-1-2 et le test de biocompatibilité selon MDD annexe I.

5) Selon le degré de protection de choc électrique, cet appareil est classé BF, selon la norme EN60601-1.

6) Changer la pile avant de faire une réclamation pour un échange

7) Ne jamais jeter le thermomètre ou la pile dans le milieu naturel mais utiliser les collecteurs prévus à cet effet.

CE **0434**

PRODUIT CONFORME AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 93/42 du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.

COTRONIC TECHNOLOGY LTD - ShenZhen - China.

EC REP LOCUS Electronics Ltd - Rochester - U.K.

Importé par :
COMED
PARC DES FORGES - 8 Rue Louise Michel
FR-67200 STRASBOURG - FRANCE